

**TELFRACOM**

Systemes d'appel et accessoires  
pour établissements de santé

[www.telfracom.fr](http://www.telfracom.fr)

**SONELCO**


**NOUVEAU**



**Systeme d'appel malade**

**P6000**

## SONELCO

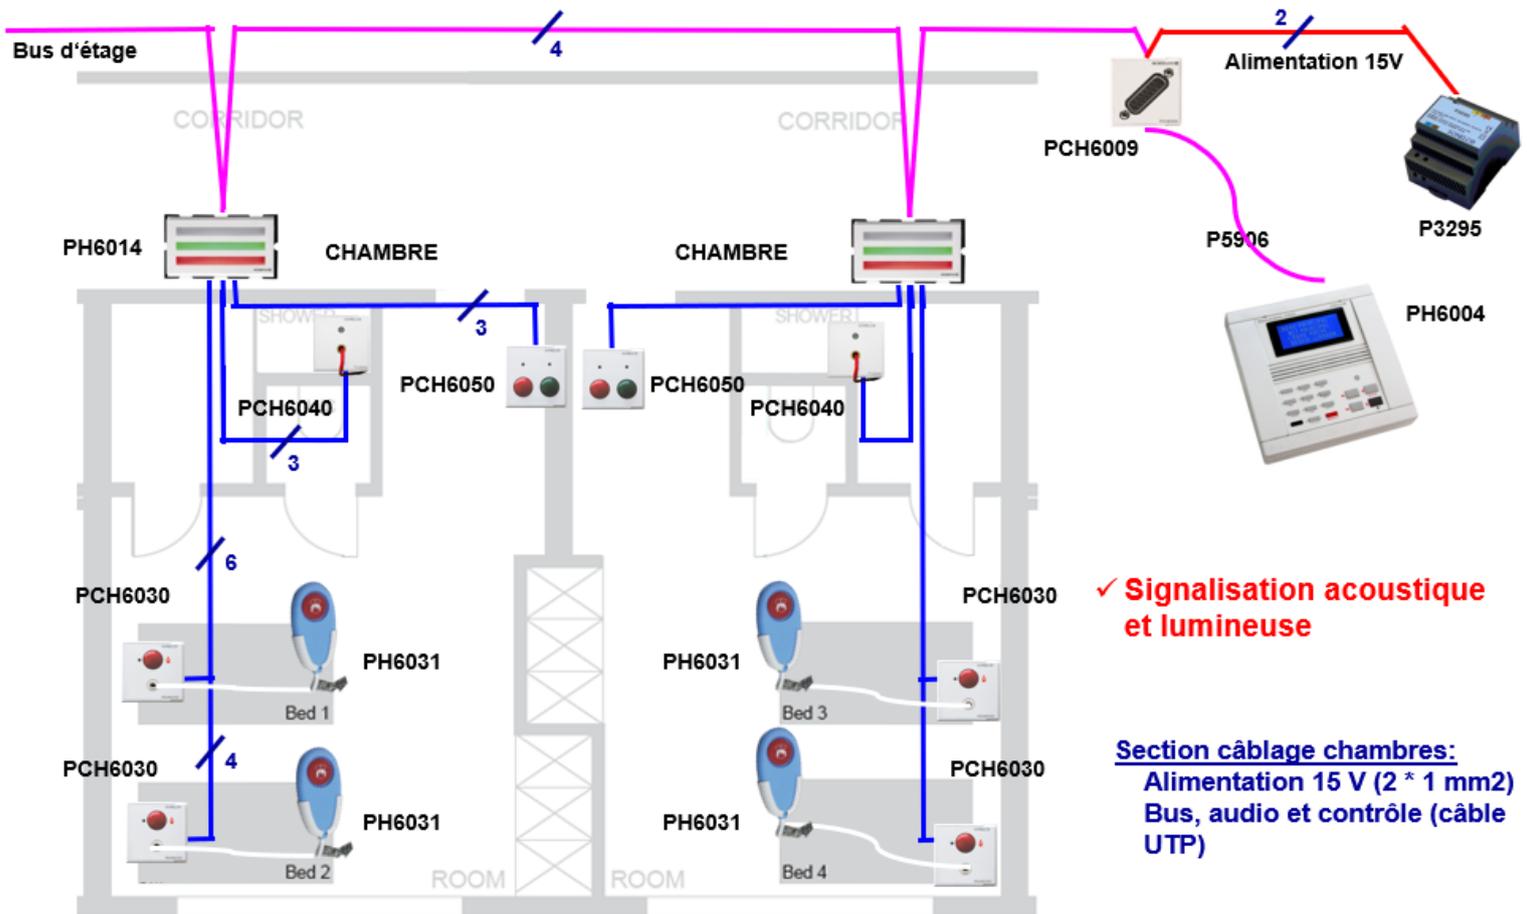

### Le système P6000 de SONELCO :

- Est simple à câbler
- Est simple à mettre en œuvre
- Répond à toutes les obligations du marché

# SONELCO

Fonctionnalités selon les modules utilisés	 PCH6022 PCH6025 PCH6021	 PCH6022 PCH6025	 PCH6022 PCH6020	 PCH6025	 PCH6020
Les modules PCH6025 et PCH6020 permettent la signalisation présence infirmière et acquittement de l'appel	✓	✓	✓	✓	✓
Le module microphone/haut-parleur PCH6022 permet l'intercommunication entre le patient et l'infirmière.	✓	✓	✓		
Le module microphone/haut-parleur PCH6022 permet également de recevoir les annonces du poste de contrôle.	✓	✓	✓		
Le module de contrôle PCH6021 permet de répondre aux appels d'une autre pièce.	✓				
L'afficheur du module PCH6025 informe des appels qui arrivent d'une autre pièce.	✓	✓		✓	

## Les combinaisons de configuration possibles :

- Sans afficheur, sans phonie
- Avec afficheurs, sans phonie
- Avec afficheurs avec phonie

## Le système d'appel malade P6000 de SONELCO c'est :

### Blocs de porte



Bloc de présence  
PCH6050



Bloc de présence  
PCH6020



Bloc Afficheur  
PCH6025



Module Micro/HP  
PCH6022



Module Intercom  
PCH6021



Bloc d'alimentation 15V  
P3295

### Blocs d'appel lit et wc



Bloc de lit  
PCH6030



Bloc de lit  
PCH6032



Poire d'appel  
PH6031



Manip. d'appel  
PH6033




Tirette d'appel  
PCH6040

### Hublots de couloir



Hublot 3 feux  
PCH6011



Hublot 1 feu  
PCH6014



Pupitre de service et de  
programmation  
PH6000 PH6004 (phonie)

**Remarque : Possibilité de renvoi vers DECT et d'historique des événements**